



**SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE FINANCIËLE  
ONDERSTEUNING VAN ORGANISATIES MET EEN ACTIVITEIT  
OP GRONDGEBIED AALST BIJ DE AANKOOP VAN EEN AED-  
TOESTEL EN/OF AED-KAST**

---



# DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

## HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

### **Artikel 1 – Voorwerp van het reglement**

Dit reglement wil bijdragen tot een verhoogde beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's), dit via het verlenen van een eenmalige subsidie aan een Aalsterse organisatie voor de aankoop van een AED en/of AED-kast in eigen beheer.

### **Artikel 2 – Territoriaal toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op elke organisatie die een activiteit uitoefent op het grondgebied Aalst, ongeacht de aard van de organisatie.

De plaatsing van de AED en/of de AED-kast kan enkel op grondgebied Aalst geschieden.

### **Artikel 3 – Doelstelling**

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een eenvoudig te gebruiken toestel dat kan aangewend worden om slachtoffers van een hartstilstand meer overlevingskansen te bieden. Het gebruik van een AED binnen de 6 minuten na levensbedreigende hartritmestoornissen verhoogt de overlevingskansen twee tot drie keer.

Het plaatsen van AED's op publieke plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar veel mensen wonen wordt dan ookaanbevolen.

De adequate bewaring van een AED in een daartoe geschikte AED-kast is eveneens van groot belang.

De 24/24 uur toegankelijkheid van de AED-toestellen verspreid over het volledige grondgebied is cruciaal. De voorziene subsidiebedragen weerspiegelen dit gedachtengoed.

De optie wordt geboden aan een organisatie die reeds beschikt over een AED-toestel om via de subsidie 'type B' een buitenkast-AED aan te kopen om het reeds voorziene AED-toestel 24 uur/ 24 uur publiek beschikbaar te stellen.

Dit subsidiereglement, waarbij Aalsterse organisaties aangespoord worden om zelf in eigen beheer een AED en een daartoe geschikte AED-kast aan te kopen, kadert in een veel groter project van de stad Aalst rond 'Aalst, hartveilige stad', waar ook de volgende aspecten aan bod komen:

- Inventarisatie van de reeds beschikbare AED's op grondgebied Aalst en het verhogen van de kennis hierover bij de burgers.
- Plaatsing van een groot aantal AED-zuilen op het openbaar domein, verspreid over het grondgebied Aalst, in beheer van de stad Aalst.



- Het aanbieden van gratis opleidingen aan burgers en organisaties rond reanimatie- technieken en het gebruik van een AED.

#### **Artikel 4 - Begrippen**

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Organisatie:

Bedrijven, verenigingen en handelszaken die een activiteit uitoefenen op het grondgebied Aalst met voornamelijk de inwoners van de stad als doelgroep.

2° AED-toestel:

Automatische Externe Defibrillator, een toestel dat op basis van een analyse een elektrische schok kan toedienen, al dan niet na een voorafgaandelijke vraag op een knop te drukken, en dat beantwoordt aan de eisen vermeld in het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de medische hulpmiddelen.

3° De werkgroep AED:

Een werkgroep, georganiseerd vanuit de dienst Noodplanning van de stad Aalst en samengesteld uit experts van verschillende relevante organisaties zoals o.a. het ASZ, het OLV-ziekenhuis, het Hulpcentrum 100/112, het Rode Kruis, de hulpverleningszone Zuid-Oost, Odisee en de federale dienst Noodplanning van de waarnemend gouverneur.

4° De aanvrager:

De rechtspersoon of de verantwoordelijke van de organisatie die de subsidieaanvraag indient en tevens de contactpersoon is ter opvolging van de aanvraag tot subsidiëring.

5° De aanvraag:

De vraag voor het verkrijgen van een subsidie bij de aankoop van een AED-toestel en/of AED-kast.

6° Dossier:

Het geheel van het document bestaande uit het aanvraagformulier en de nodige verplichte bijlagen, waarvan sprake in dit reglement.

7° AED 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk:

Een locatie waar elke burger -dus niet enkel de personen betrokken bij de eigen organisatie- te allen tijde de AED kan ontlenen voor gebruik in geval van een hartstilstand.

#### **Artikel 5 - Afbakening**

Particulieren kunnen geen aanvraag doen voor een AED-toestel en/of AED-kast.

Voor AED's en AED-kasten die reeds aangekocht en geplaatst zijn, kan geen subsidie aangevraagd worden.

Per toekomstige AED en AED-kast kan een organisatie slechts 1 dossier indienen.

De aanvrager kan bij een goedgekeurde aanvraag genieten van een subsidie. Deze subsidie kan nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke factuurprijs voor de aankoop en installatie van het AED-toestel.

Het is verboden voor één en hetzelfde AED-toestel subsidies te cumuleren, die verstrekt worden op grond van meerdere subsidiereglementen van de Stad of haar autonome gemeentebedrijven.



In geval van cumuleren van de toelage verstrekt door de stad o.g.v. onderhavig reglement met toelagen verstrekt door andere overheden of door privé-instanties, wordt het subsidiebedrag verstrekt door de stad sowieso afgetopt op maximaal het saldo ten opzichte van 100% van het aankoopbedrag.

De gesubsidieerde AED(kast) dient geplaatst te worden op het privédomein van de organisatie of op het privédomein van een derde mits het kunnen voorleggen van de schriftelijke toestemming van de eigenaar tot plaatsing van een AED-kast op het betrokken domein.

### **Artikel 6 – Types subsidie**

Het reglement voorziet in 8 verschillende types subsidie:

- Type A:  
subsidie voor een aankoop van een AED-binnenkast (zonder AED-toestel)  
vastgesteld op 100,- EUR
- Type B:  
subsidie voor een aankoop van een AED-buitenkast (zonder AED-toestel)  
vastgesteld op 300,- EUR
- Type C:  
subsidie voor de aankoop van een AED die 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 900,- EUR
- Type D:  
subsidie voor de aankoop van een AED die niet 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 500,- EUR
- Type E:  
subsidie voor de gezamenlijke aankoop van een AED-binnenkast en een AED die niet 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 600,- EUR
- Type F:  
subsidie voor de gezamenlijke aankoop van een AED-buitenkast en een AED die niet 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 800,- EUR
- Type G:  
subsidie voor de gezamenlijke aankoop van een AED-buitenkast en een AED die 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 1 200,- EUR
- Type H:  
subsidie voor de gezamenlijke aankoop van een AED-binnenkast en een AED die 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk zal gesteld worden vastgesteld op 1 000,- EUR

De aanvrager engageert zich te voldoen aan de voorwaarden gekoppeld aan het type subsidie.

### **Artikel 7 – Openbaarheid locatie AED**

Een organisatie die subsidiëring ontvangt voor een AED en/of AED-kast vanuit de stad Aalst stemt ermee in dat de locatie van de desbetreffende AED(kast) zal opgenomen worden in de inventarisatielijst van de AED's op grondgebied Aalst die via diverse kanalen zal bekend gemaakt worden.



## DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

### HOOFDSTUK II: TECHNISCHE VOORWAARDEN AED & AED-KAST

#### Artikel 8 – Technische bepalingen AED-toestel

Om voor een subsidiëring in aanmerking te komen, moet het AED-toestel vermeld op de offerte voldoen aan volgende voorwaarden:

- Het betreft een AED toestel van het type “AED categorie 1” volgens het hoofdstuk I, art. 1 – 2° van het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van reanimatie (B.S. 18 mei 2007): te weten: “een automatische externe defibrillator die niet toelaat om te schakelen naar een manuele modus en aldus zelfstandig een elektrische schok toe te dienen, en die niet over een scherm beschikt om het hartritme te volgen.”
- Het AED toestel is volautomatisch en dient zelf de schok toe, na duidelijke auditieve waarschuwing.
- Het betreft een bifasisch AED toestel met niet-gepolariseerde elektroden.
- Het AED toestel is geprogrammeerd volgens de ERC-richtlijnen van 2015. Het is mogelijk bij wijzigingen van de ERC-richtlijnen deze programmatie als dusdanig aan te passen.
- De asystolie detectiedrempel wordt vastgelegd op maximaal 100  $\mu$ V Peak-to-Peak (Top-Top) of overeenstemmende waarde in RMS (Root Mean Square) of Peak-to-Zero (Top-Nullijn).
- Het AED toestel is uitgerust met een aangesloten paar standaard elektroden.
- Het AED toestel is voorzien van een duidelijke batterij-indicator die de staat van de batterij aangeeft.
- Het AED toestel heeft Nederlands als standaardtaal en bij voorkeur kan nog een tweede en/of derde taal worden ingesteld.
- Het AED toestel heeft bij voorkeur een grote display waarop de batterijstatus, de tijdsduur, het aantal toegediende schokken en tekstberichten kunnen worden weergegeven.
- Het AED toestel ondersteunt de reanimatie bij voorkeur aan de hand van gesproken boodschappen, een metronoom en feedback aangaande de praktische uitvoering van de reanimatie (snelheid en diepte van de toegediende compressies).
- Het AED toestel is bij voorkeur uitgerust met pacemakerdetectie om een ventrikelfibrillatie correct te kunnen onderkennen.
- Het AED toestel heeft bij voorkeur een hoog maximaal energiebereik, uitgedrukt in joules. Het maximaal energiebereik van het AED toestel voldoet aan de ERC-richtlijnen van 2015 inzake defibrillatie.
- Het AED toestel beschikt bij voorkeur over de mogelijkheid om pediatrie elektroden, voor gebruik bij kinderen < 8 jaar en/of < 25 kg, aan te sluiten. Indien geen pediatrie elektroden op het AED toestel kunnen worden aangesloten is de mogelijkheid om een



reanimatie in kindermodus op te starten door middel van een specifieke knop of sleutel wenselijk. Indien de AED werkt met kinderelektroden, dan wordt een set standaard bij geleverd.

- De elektroden hebben bij voorkeur een hoge levensduur.
- De batterij heeft bij voorkeur een hoge levensduur in stand-by.
- Het AED toestel is bij voorkeur uitgerust met een zelftest-systeem waarbij:
  - De batterij, de benodigde software en de elektronische circuits automatisch op dagelijkse basis worden getest.
  - De energielading en de energieladcyclus automatisch op periodieke basis worden getest.
  - Bij het vaststellen van een probleem dit aan de buitenzijde van het toestel visueel en/of auditief wordt aangegeven.
- Het AED toestel is regen- en stofbestendig, uitgedrukt als IP-waarde.
- Het AED toestel beschikt bij voorkeur over een intern geheugen waarop meer dan één interventie (ECG-registratie en/of omgevingsgeluiden) tegelijkertijd kan opgeslagen worden en een zo groot mogelijke opslagcapaciteit uitgedrukt in minuten.
- Na gebruik kan het AED toestel door middel van bijgeleverde software worden uitgelezen. De software valt niet onder de bepalingen van een licentie. Indien vereist wordt de datakabel bijgeleverd.
- Per toestel worden 2 AED stickers bij geleverd om de aanwezigheid van een AED kenbaar te maken. Deze stickers voldoen aan het koninklijk besluit van 21 april 2007
- Elke AED wordt voorzien van alle gegevens voor de wettelijk verplichte registratie, alsook de gegevens van de exacte locatiebepaling (x, y coördinaten) en de topografische kaart
- Het hulptasje is inclusief en heeft als inhoud: nitrile handschoenen Large & Extra Large, beademingsmasker, scheermes, absorberend kompres, ambulanciersschaar, Nederlandstalige handleiding, verplichte A4geheugensteun.
- Per toestel wordt een onderhoudsboekje geleverd;
- Als verplichte bijlage bij de offerte, wordt de technische fiche en de Nederlandstalige gebruikershandleiding van de aangeboden AED bijgeleverd.

In bijlage 3 van het subsidiereglement kan u een checklist terugvinden, waarin het onderscheid wordt gemaakt van vereiste en aanbevolen technische kenmerken van het AED-toestel.

### **Artikel 9 – Technische bepalingen AED-buitenkast**

Indien een AED-toestel publiek en 24u/24u beschikbaar is dan dienen deze te worden opgeborgen in een AED-buitenkast. Om voor een subsidiëring van een AED-buitenkast in aanmerking te komen, moet de AED-buitenkast vermeld op de offerte, voldoen aan volgende voorwaarden:

- de AED-buitenkast is van groene kleur (officiële groene AED kleur) om de herkenbaarheid te verhogen;
- het betreft een weersbestendige AED-buitenkast, met genummerde verzegeling;
- op de AED-buitenkast is een AED-pictogram aangebracht, zoals omschreven in BS21-04-2007;
- de volgende vermelding is aangebracht op de AED-buitenkast: “Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds



het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED”;

- op de voorkant van de AED-buitenkast moeten er overlevingsinstructies en drie duidelijke pictogrammen staan die aanduiden welke stappen moeten worden doorlopen in geval van gebruik;
- in de AED-buitenkast is plaats voor opslag van het AED-toestel, elektroden en hulptasje;
- de AED-buitenkast is voorzien van een auditief en visueel signaal dat geactiveerd wordt bij het wegnemen van het AED-toestel of het openen van de kast;
- om het AED-toestel op de juiste werkingstemperatuur te houden, is de AED-buitenkast voorzien van een ventilator en een verwarmingselement. Beide elementen houden, door middel van een thermostaat, rekening met de temperatuur in de kast en handhaven de beste werkingstemperatuur van het toestel. Bij een probleem aan de temperatuurconsole wordt dit visueel aangegeven. Het is dus noodzakelijk dat de AED-buitenkast voorzien is van elektriciteit;
- ledverlichting in de AED-buitenkast is voorzien met ingebouwde lichtsensoren voor dag- en nachtstand;
- de AED-buitenkast is gemakkelijk te openen;
- Als verplichte bijlage bij de offerte, wordt de technische fiche en de Nederlandstalige gebruikershandleiding van de aangeboden AED-buitenkast bijgeleverd.

#### **Artikel 10 – Technische bepalingen AED-binnenkast**

Indien de locatie van een AED-toestel voorzien wordt binnen een bepaalde binnenruimte, wordt nog steeds aanbevolen deze op te bergen in een AED-binnenkast. Om voor een subsidiëring van een AED-binnenkast in aanmerking te komen, moet de AED-binnenkast vermeld op de offerte voldoen aan volgende voorwaarden:

- de AED-binnenkast is van groene kleur (officiële groene AED kleur) om de herkenbaarheid te verhogen. De binnenkast is voorzien van genummerde verzegeling;
- op de AED-binnenkast is een AED-pictogram aangebracht, zoals omschreven in BS21-04-2007;
- de volgende vermelding is aangebracht op de AED-binnenkast: “Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED”;
- op de voorkant van de AED-binnenkast moeten er overlevingsinstructies en drie duidelijke pictogrammen staan die aanduiden welke stappen moeten worden doorlopen in geval van gebruik;
- in de AED-binnenkast is plaats voor opslag van het AED-toestel, elektroden en hulptasje;
- de AED-binnenkast is voorzien van een auditief en visueel signaal dat geactiveerd wordt bij het wegnemen van het AED-toestel of het openen van de kast;
- de AED-binnenkast is gemakkelijk te openen;
- Als verplichte bijlage bij de offerte, wordt de technische fiche en de Nederlandstalige gebruikershandleiding van de aangeboden AED-binnenkast bijgeleverd.



## HOOFDSTUK III : PROCEDURE TOT AANVRAAG

### Artikel 11 – Adviesaanvraag

De aanvrager heeft de mogelijkheid om op voorhand vrijblijvend advies in te winnen bij de werkgroep AED. Dit kan enkel mits geschreven vraagstelling via de volgende kanalen:

- via email naar [AED@aalst.be](mailto:AED@aalst.be)
- via brief naar Stad Aalst – dienst Integrale veiligheid, Werf 9 te 9300 Aalst

Voor de behandeling van de adviesaanvraag dient men te rekenen op 40 kalenderdagen na ontvangst.

Het vrijblijvend indienen en ontvangen van een adviesaanvraag staat los van de termijnen en verplichtingen vermeld in dit reglement.

### Artikel 12 – Timing indienen aanvraagdossier

Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni binnen het betreffende budgetjaar.

### Artikel 13 – Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is beschikbaar via bijlage 1 van dit document. Een digitale invulversie is beschikbaar op de website van de stad Aalst of op eenvoudig verzoek te verkrijgen via het e-mailadres [aed@aalst.be](mailto:aed@aalst.be).

Het aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de gemachtigden van de organisatie en overgemaakt worden via post of e-mail.

### Artikel 14 – Verplichte inhoud aanvraagdossier

Het ingevulde aanvraagformulier te vinden in bijlage 1 van dit reglement is een verplicht onderdeel van een dossier.

Naast het ingevulde aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen verplicht toegevoegd te worden aan het dossier:

- Een zo gedetailleerd mogelijke offerte voor de aankoop van een AED-toestel en/of AED-kast. De offerte mag maximum 3 maand oud zijn op de dag van de aanvraag. Enkel offertes die volgens dit reglement als geldig worden aanvaard, worden weerhouden. Een geldige offerte is een document dat minimaal de volgende informatie bevat: naam en adres van de verkoper, naam en adres van de koper, een geldelijk bedrag met een onderscheid tussen inclusief BTW en exclusief BTW, een gedetailleerde omschrijving van het AED-toestel (merk + type) en/of AED-kast en de factuurdatum.
- De technische fiche van het AED-toestel en/of AED-kast zoals vermeld op de offerte.
- Detailfoto('s) van de exacte locatie waar de toekomstige AED(kast) zal geplaatst worden.
- De eigendomsakte van het domein waarop de AED(kast) zal geplaatst worden en een ondertekende schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie tot plaatsing van een AED-kast op zijn/haareigendom.



**Artikel 15 – Wijze indienen aanvraagdossier**

De aanvrager kan zijn dossier indienen via de volgende kanalen:

- via email naar AED@aalst.be
- via brief naar Stad Aalst – dienst Integrale veiligheid, Werf 9 te 9300 Aalst

**Artikel 16 – Ontvankelijkheid aanvraagdossier**

Alle aanvragen worden gecontroleerd op hun ontvankelijkheid door de werkgroep AED. Indien de aanvraag ontvankelijk is, zal de aanvrager hiervan een bevestiging via e-mail ontvangen.

Indien een aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld van de gebreken binnen de 7 weken na ontvangst van de aanvraag.

Vervolgens kan de aanvrager zijn aanvraag regulariseren en opnieuw indienen binnen de 2 weken na ontvangst van de opmerkingen. Bij het niet halen van deze termijn, behoudt de aanvrager steeds het recht om zijn dossier opnieuw in te dienen voor behandeling in het erop volgende jaar.

**Artikel 17 – Procedure bij een gecentraliseerd aanvraagdossier**

Een aanvraag indienen voor meerdere AED-toestellen en/of AED-buitenkasten via 1 aanvraagdossier is niet mogelijk. De aanvrager dient voor elke locatie waar hij/zij een AED(kast) wenst te plaatsen een apart dossier op te stellen.

**Artikel 18 – Wijziging aanvraagdossier**

Iedere wijziging binnen de organisatie of/en het engagement tot aankoop van een AED(kast) dient door de aanvrager onverwijld aan de werkgroep AED gemeld te worden. Dit zodat het dossier herbekeken kan worden.

**Artikel 19 – Extra informatie in kader van aanvraagdossier**

Ter ondersteuning van het formuleren van een advies door de werkgroep AED dienen volgende documenten na eenvoudig verzoek van de werkgroep AED voorgelegd te kunnen worden binnen de 15 dagen na aanvraag:

**1° Verenigingen**

- een ledenlijst met actieve leden,
- een werkingsverslag van het voorbije jaar met een overzicht van de werkingsmomenten (datum, plaats, omschrijving, aantal deelnemers),
- Organogram van het bestuur.

**2° Bedrijven of handelszaken**

- BTW-nummer en handelsnummer,
- lijst van alle hulpverleners binnen het bedrijf (naam en telefonische contactgegevens),
- naam en telefonische contactgegevens van de verantwoordelijke voor welzijn op het werk,
- contactgegevens van de bevoegde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk,
- Organogram van het bestuur.



## HOOFDSTUK IV: BEHANDELING AANVRAAGDOSSIER DOOR WERKGROEP AED

### Artikel 20 – Toekenningscriteria

**1°** Een aanvraag kan afgekeurd worden indien de locatie van de AED niet past in het spreidingsplan (bv. het verenigingslokaal is gelegen naast een woon- en zorgcentrum van het OCMW waar reeds een 24 uur/24 uur publiek toegankelijk AED-toestel geplaatst werd of bv. een organisatie die gelegen is in een weinig bevolkt/bezocht gebied).

**2°** Gelet op het feit dat het voorziene budget per jaar wordt geplafonneerd, geldt het principe first come, first serve, op voorwaarde dat het voorziene budget niet bereikt werd. Organisaties die hierdoor geen subsidie hebben gekregen, worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen het volgende kalenderjaar opnieuw een aanvraag indienen. Elk jaar worden deze aanvragen opnieuw geëvalueerd op hun ontvankelijkheid.

### Artikel 21 – Beslissing door college van burgemeester en schepenen

De werkgroep AED zal een positief of negatief advies formuleren bij elke ontvankelijk verklaarde aanvraag en dit advies vervolgens ter kennis brengen aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit advies zal het college een aanvraag al dan niet goedkeuren.

**HOOFDSTUK V : TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE****Artikel 22 – In kennis stelling van de beslissing**

Na ontvangst van een volledig en technisch goedgekeurd subsidiedossier, wordt dit dossier binnen de drie weken voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.

**Artikel 23 – Aankoop & plaatsing AED en/of AED-kast**

De aanvrager krijgt vervolgens tot 30 november de tijd om de aankoop en plaatsing van het AED-toestel en/of de AED-kast volgens de ingediende offerte te finaliseren.

**Artikel 24 – Aanleveren bewijs van aankoop & plaatsing AED en/of AED-kast**

De aanvrager dient tegen uiterlijk 30 november de volgende documenten in kader van bewijs van de aankoop en plaatsing van het AED-toestel en/of de AED-kast aan te leveren aan de werkgroep AED:

- Een zogedetailleerd mogelijke factuur voor de aankoop van een AED-toestel en/of AED-kast. Enkel facturen die volgens dit reglement als geldig worden beschouwd, worden weerhouden. Een geldige factuur is een document dat minimaal de volgende informatie bevat: naam en adres van de verkoper, naam en adres van de koper, een geldelijk bedrag met een onderscheid tussen inclusief BTW en exclusief BTW, een gedetailleerde omschrijving van het AED-toestel (merk + type) en/of AED-kast, het serienummer van het gekochte artikel en defactuurdatum.
- Een foto van de geïnstalleerde AED(kast) op de daartoe voorziene locatie.
- De contactgegevens (minimaal emailadres en telefoonnummer) van de contactpersoon in kader van een controlebezoek door de werkgroep AED.

Dit kan via volgende kanalen:

- via email naar [AED@aalst.be](mailto:AED@aalst.be)
- via brief naar Stad Aalst – dienst Integrale veiligheid, Werf 9 te 9300 Aalst

Aanvragers die het bewijs van aankoop & plaatsing niet tijdig kunnen aanleveren aan de werkgroep AED, zullen alsnog geweerd worden van de subsidie-uitkering. Deze organisaties worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen het volgende kalenderjaar opnieuw een aanvraag indienen. Elk jaar worden deze aanvragen opnieuw geëvalueerd op hun ontvankelijkheid.

**Artikel 25 – Ontvankelijkheid stavingstukken aankoop & plaatsing**

Alle stavingstukken worden gecontroleerd op hun ontvankelijkheid door de werkgroep AED.

Indien deze ontvankelijk zijn, zal de aanvrager hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen, samen met een eventueel voorstel tot controlebezoek, zie artikel 26.



Indien de stavingsstukken niet ontvankelijk verklaard worden, zal de aanvrager geen kans meer krijgen om zijn documenten te regulariseren voor behandeling binnen het betrokken budgetjaar.

De aanvrager behoudt weliswaar steeds het recht om zijn dossier opnieuw in te dienen voor behandeling in het erop volgende jaar. Deze hernieuwde aanvraag zal -mits rechtzetting van de aandachtspunten en mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen- prioritair behandeld worden.

#### **Artikel 26 – Controlebezoek door lid werkgroep AED**

Indien de aangeleverde stavingsstukken geen correcte plaatsing van het toestel kunnen aantonen, zal een lid van de werkgroep AED een controlebezoek brengen aan de organisatie. De betrokken organisatie dient hieraan gevolg te geven.

De volgende niet-limitatieve lijst met evaluatiepunten zal gehanteerd worden:

- vakkundigheid en volledigheid van de plaatsing
- locatie conform het aanvraagdossier
- aanwezig materiaal conform de aangeleverde facturen

#### **Artikel 27 – Procedure bij negatieve evaluatie tijdens controlebezoek**

Bij een negatieve evaluatie op één van de deelaspecten, zal de aanvrager alsnog geweerd worden van de subsidie-uitkering voor het betrokken budgetjaar.

De aanvrager behoudt weliswaar steeds het recht om zijn dossier opnieuw in te dienen voor behandeling bij een volgende procedure-aanvraag. Deze hernieuwde aanvraag zal -mits rechtzetting van de aandachtspunten en mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen- prioritair behandeld worden.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, of dat de voorwaarden van de reglementering niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen geen toelage toe te kennen of de op grond van dit reglement toegekende toelage volledig of gedeeltelijk terug te vorderen van het betrokken initiatief.

Premies die worden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden ongeacht van eventueel gerechtelijke vervolging.

#### **Artikel 28 – Storting subsidiebedrag**

Na een positief advies van het betrokken lid van de werkgroep AED die het eventuele controlebezoek uitgevoerd heeft, wordt het subsidiebedrag doorgestort op het aangegeven rekeningnummer van de organisatie via het aanvraagformulier.

Het rekeningnummer waarop de subsidie gestort wordt, moet op de naam van de organisatie staan. Op persoonlijke rekeningen wordt geen subsidie gestort.



## DEEL 3: SLOTBEPALINGEN

### HOOFDSTUK VI : AANSPRAKELIJKHEID EN BETWISTING

#### **Artikel 29 - Eigendom**

De aanvrager dient zelf de aankoop van de AED en/of de AED-kast te doen. De volledige eigendomsrechten blijven dan ook bij de aanvrager.

De stad kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de werking of gebruik van het toestel.

#### **Artikel 30 - Plaatsing**

De aanvrager dient zelf alle nodige stappen te ondernemen betreffende de aankoop en plaatsing van de AED en/of de AED-kast. De aanvrager dient eveneens zelf alle bijkomende kosten te dragen die voortvloeien uit gebruik en onderhoud van zowel het AED-toestel als de AED-kast.

#### **Artikel 31 - Onderhoud**

De aanvrager dient zelf in te staan voor een periodiek onderhoud en de kosten die hieruit voortvloeien.

#### **Artikel 32 – Opvolging**

De stad behoudt zich het recht om een controlebezoek uit te voeren waarbij nagegaan wordt of de voorwaarden gekoppeld aan de ontvangen subsidie (bv. buitenplaatsing van een AED) nageleefd worden. Bij niet naleving van de voorwaarden kan overgegaan worden tot een terugvordering van de uitbetaalde subsidie.

#### **Artikel 33 - Verzekering**

De aanvrager wordt geacht om zelf de nodige verzekeringsmaatregelen te treffen en de kosten hiervoor te dragen. Vandalisme, diefstal en andere risico's moeten zelf verzekerd worden door de aanvrager. De stad Aalst kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij schadegevallen.

#### **Artikel 34 - Betwisting**

Alle betwistingen die volgen uit de hantering van dit reglement of/en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.



## HOOFDSTUK VII : BEPALINGEN REGLEMENT

### **Artikel 35 – Inwerkingtreden reglement**

Dit reglement is, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, van onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2021.

### **Artikel 36 – Bekendmaking**

Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet.

### **Artikel 37 – Openbaarheid van bestuur**

Dit reglement wordt ter beschikking gesteld via de website van de stad Aalst ([www.aalst.be](http://www.aalst.be)) en wordt ter inzage gelegd op de dienst Onthaal in het administratief centrum van de stad te Werf 9.

## BIJLAGEN



## Bijlage 1: aanvraagformulier

U kan de aanvraag op volgende manieren vervolledigen:

- Het aanvraagformulier manueel invullen en doormailen naar [aed@aalst.be](mailto:aed@aalst.be) of via post overmaken (Stad Aalst – dienst Integrale veiligheid – Werf 9, 9300 Aalst),

IDENTITEIT ORGANISATIE			
<b>Naam organisatie</b>			
<b>Juridische structuur organisatie</b>			
<b>Activiteit / aard organisatie</b>			
<b>Aantal leden organisatie</b>			
<b>Ingeschatte bezetting van de voorziene AED-locatie</b>	Weekdag: ___personen	Weekavond: ___personen	Weekend: ___personen
<b>Naam contactpersoon dossier AED</b>			
<b>Functie contactpersoon binnen de organisatie</b>			
<b>Adres contactpersoon dossier AED</b>			
<b>Telefoonnummer contactpersoon</b>			
<b>E-mail contactpersoon</b>			
BETALINGSGEGEVENS			
<b>Bankrekeningnummer organisatie</b>			
<b>Naam titularis van de rekening</b>			
<b>Adres titularis van de rekening</b>			
TYPE SUBSIDIE			
<b>Duid aan voor welk type subsidie u een aanvraag indient (zie artikel 6)</b>	<input type="checkbox"/> Type A	<input checked="" type="checkbox"/> Type E	
	<input type="checkbox"/> Type B	<input checked="" type="checkbox"/> Type F	
	<input checked="" type="checkbox"/> Type C	<input checked="" type="checkbox"/> Type G	
	<input checked="" type="checkbox"/> Type D	<input checked="" type="checkbox"/> Type H	



SPECIFICATIES AED	
Type AED, vermeld op de offerte	
Type AED-kast, vermeld op de offerte	
Adres toekomstige locatie AED	
Beschrijf de specifieke locatie in woorden (bvb: buiten aan de personeelsingang, 2 meter rechts van het groene toegangshek aan de x-sstraat)	

**Duid aan wat u bij dit formulier heeft meegestuurd (zie artikel 14):**


- Een gedetailleerde offerte van maximum 3 maanden oud
- De technische fiche van het AED-toestel en/of de AEDkast
- Detailfoto('s) van de exacte locatie waar de AED zal geplaatst worden.
- De eigendomsakte van het domein waarop de AED(kast) zal geplaatst worden en een ondertekende schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie tot plaatsing van een AED-kast op zijn/haareigendom.

**Ondergetekende bevestigt dat alle gegevens correct zijn ingevuld en dat de ingevoegde bijlagen correct zijn.****Bij een positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de toekenning van de subsidie verbindt ondergetekende er zich toe over te gaan tot de aankoop en plaatsing van het AED-toestel en/of AED-kast.**

<b>DATUM:</b>	
<b>GEMACHTIGDE 1</b>	<b>GEMACHTIGDE 2</b>
NAAM EN HANDTEKENING VOOR WAAR EN ECHT VERKLAARD	NAAM EN HANDTEKENING VOOR WAAR EN ECHT VERKLAARD
<b>DIT FORMULIER MET DE NODIGE BIJLAGEN BEZORGEN AAN DE WERKGROEP AED: AED@aalst.be STAD AALST TAV DIENST NOODPLANNING - WERF 9 -9300 AALST UITERSTE DATUM INDIENEN AANVRAAGDOSSIER : 30 JUNI</b>	



## Bijlage 2: tijdslijn

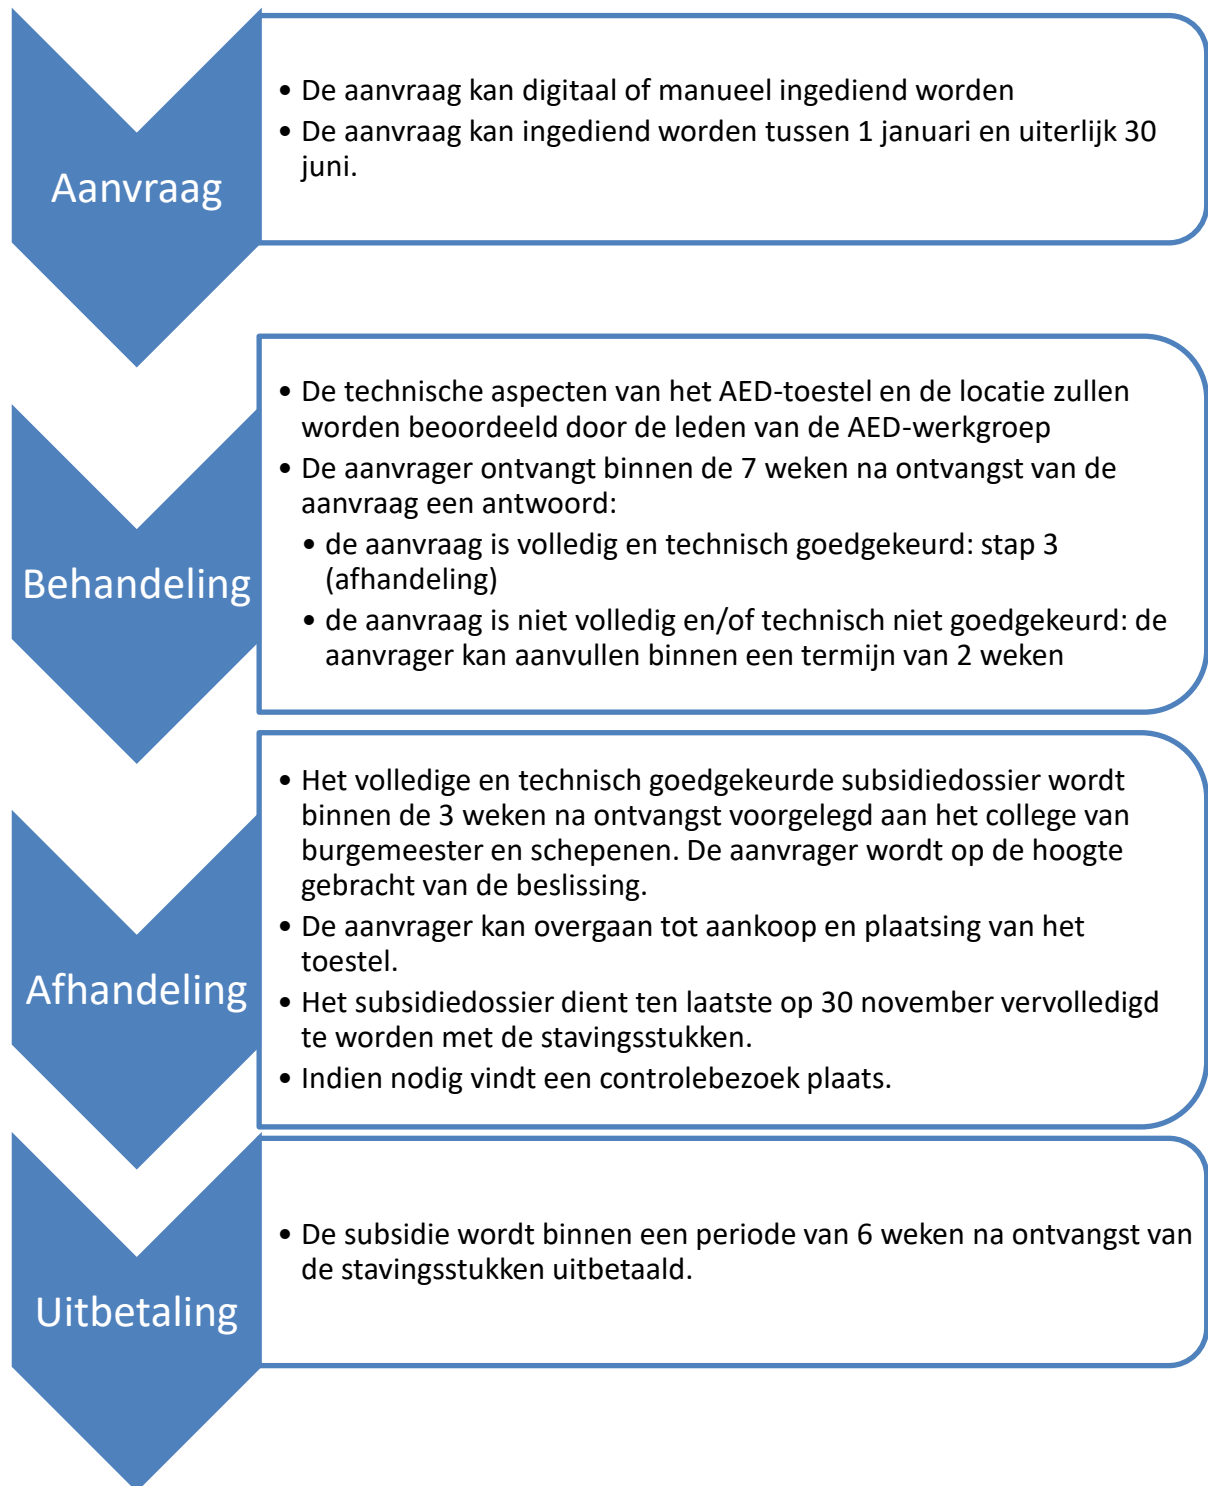

## Bijlage 3: technische checklist

De 'technische checklist' bestaat uit twee onderdelen:

- de minimumvereisten waar het toestel aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.
- bijkomende kenmerken die aanbevolen, maar niet vereist zijn.

Een uitgebreide beschrijving van onderstaande technische kenmerken, alsook de kenmerken waaraan de AED-kast dient te voldoen, zijn terug te vinden onder 'Deel II' van deze subsidieaanvraag. Deze checklist kan u gebruiken bij de offerteaanvraag via uw leveranciers.

### Minimumvereisten AED-toestel

Vereiste	Ja	Nee
Type "AED categorie 1" volgens het hoofdstuk I, art. 1 – 2° van het KB van 21 april 2007		
Volautomatisch AED-toestel		
Bifasisch AED toestel met niet-gepolariseerde elektroden		
Geprogrammeerd volgens de ERC-richtlijnen van 2015		
Asystolie detectiedrempel wordt vastgelegd op maximaal 100 µV Peak-to-Peak		
Uitgerust met een aangesloten paar standaard elektroden		
Voorzien van een duidelijke batterij-indicator		
Toestel heeft Nederlands als standaardtaal		
Regen- en stofbestendig, uitgedrukt als IP-waarde		
Na gebruik kan het AED toestel door middel van bijgeleverde software worden uitgelezen.		
Per toestel worden 2 AED stickers bij geleverd om de aanwezigheid van een AED kenbaar te maken		
Het hulptasje is inclusief en heeft als inhoud: nitrile handschoenen Large & Extra Large, beademingsmasker, scheermes, absorberend kompres, ambulanciersschaar, Nederlandstalige handleiding, verplichte A4 geheugensteun.		
Per toestel wordt een onderhoudsboekje geleverd		
Als verplichte bijlage bij de offerte, wordt de technische fiche en de Nederlandstalige gebruikershandleiding van de aangeboden AED bijgeleverd		

## Aanbevolen toestelkenmerken

<b>Kenmerk</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
Toestel heeft bij voorkeur een grote display waarop de batterijstatus, de tijdsduur, het aantal toegediende schokken en tekstberichten kunnen worden weergegeven.		
Toestel is bij voorkeur uitgerust met pacemakerdetectie		
Toestel heeft bij voorkeur een hoog maximaal energiebereik, uitgedrukt in joules		
Toestel beschikt bij voorkeur over de mogelijkheid om pediatrie elektroden, voor gebruik bij kinderen < 8 jaar en/of < 25 kg, aan te sluiten.		
Elektroden hebben bij voorkeur een hoge levensduur		
Batterij heeft bij voorkeur een hoge levensduur in stand-by		
AED toestel is bij voorkeur uitgerust met een zelftest-systeem waarbij: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De batterij, de benodigde software en de elektronische circuits automatisch op dagelijkse basis worden getest.</li><li>▪ De energielading en de energielaadcyclus automatisch op periodieke basis worden getest.</li><li>▪ Bij het vaststellen van een probleem dit aan de buitenzijde van het toestel visueel en/of auditief wordt aangegeven.</li></ul>		
Toestel beschikt bij voorkeur over een intern geheugen waarop meer dan één interventie (ECG-registratie en/of omgevingsgeluiden) tegelijkertijd kan opgeslagen worden en een zo groot mogelijke opslagcapaciteit uitgedrukt in minuten.		